



РСЦИМ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Прессы испытательные гидравлические ИП-1000 предназначены для статических испытаний на сжатие образцов бетонов, кирпича и других строительных материалов по ГОСТ 10180, ГОСТ 12801, ASTM C 109, ASTM C 39, EN 196-1, DIN 18501 и др.

Прессы ИП-1000 оснащены силоизмерителем и модифицированы измерительной системой СИ-2. Система СИ-2 отображает в реальном времени создаваемую на образец нагрузку и скорость нагружения в кН/с, имеет четыре уровня защиты от перегрузки и три диапазона измерения. Нагружающий модуль прессы оснащен двумя винтовыми вертикальными колоннами, по которым вручную перемещается подвижная траверса.

Прессы испытательные ИП-1000 устанавливаются на фундамент высотой не менее 400 мм.

По отдельному заказу машины на сжатие ИП-1000 могут быть оснащены дополнительными приспособлениями и устройствами.

Особенности машин ИП-1000:

- ручное управление процессом нагружения;
- гидравлическая система создания нагрузки;
- отображения данных испытания на цифровом дисплее системы СИ-2;
- автоматическое поддержание скорости нагружения;
- тип силоизмерителя - торсионный электрогидравлический трехдиапазонный;
- модульная конструкция: силозадающий модуль, электрогидравлический шкаф управления;
- вертикальное двухколонное однозонное исполнение силовой рамы;
- цельнолитая траверса со встроенным силовым гидроцилиндром;
- высокая жесткость силовой рамы.



Технические характеристики:

Модификация	ИП-1000
Наибольшая создаваемая нагрузка, кН	1000
Тип привода и силоизмерителя	Электрогидравлический, торсионный
Отображение данных испытания	Цифровой дисплей системы СИ-2
Диапазон измерения основной / дополнительный, кН	20-1000 / 10-20
Погрешность при нагружении, %	± 1
Рабочий ход гидравлического поршня, мм	100
Высота рабочего пространства, включая ход гидравлического поршня, мм	510
Максимальная скорость перемещения гидравлического поршня, мм/мин	120
Расстояние между колоннами, мм	390
Размеры плит сжатия, мм	320x320
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	1600x950x1900
Масса испытательной машины, кг, не более	1700
Мощность, кВт	3,0
Электропитание, В/Гц	~380/50

Примечание: Технические характеристики указаны для машин в стандартном исполнении.

Государственный реестр типа средств измерений



№ 11161-05




МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модернизированные испытательные прессы ИП-1000-М-ТЕСТ оснащены электронно-цифровой системой измерения «М-Test», которая позволяет отображать, обрабатывать и протоколировать результатов проводимых испытаний в режиме реального времени (осуществление вывода на ПК). Управление испытательной машиной производится в ручном режиме.

В том числе модернизация позволяет:

- строить графики в режиме реального времени «Нагрузка – Перемещение», «Нагрузка – Время», «Перемещение - Время»;
- определять текущее и максимальное значение нагрузки и деформацию приложенной к образцу;
- определять текущие скорости перемещения (мм/с) и нагружения (кН/с);
- экспортировать результаты испытаний в формат Excel и др. форматы;
- сохранять результаты испытаний и загрузки ранее сохраненных результатов для последующей обработки;
- подключить дополнительные датчики и учет их показаний в расчетах.

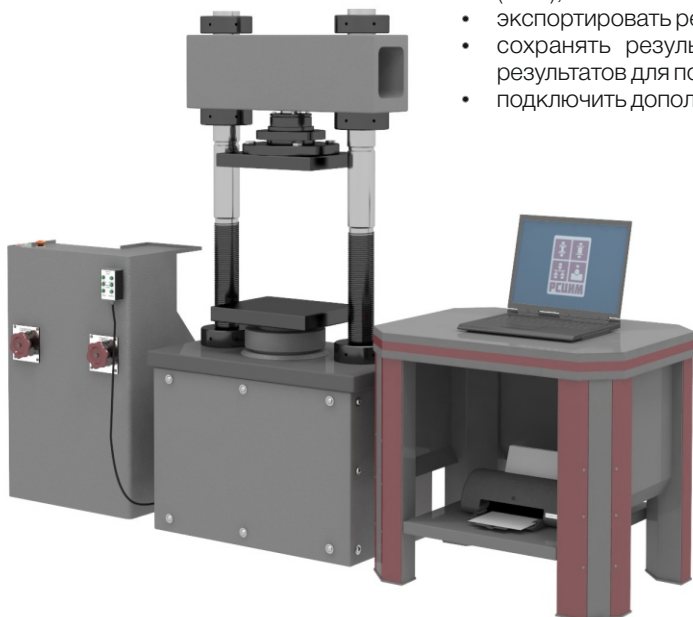

Технические характеристики модернизированной машины ИП-1000-М-ТЕСТ:


Цена наименьшего разряда силоизмерителя в зависимости от максимального усилия машины, кН	0,001
Диапазон рабочих скоростей нагружения, кН/с	1~100
Пределы допускаемой относительной погрешности силоизмерителя, % · модификация ИП-1000-М-ТЕСТ-2 · модификация ИП-1000-М-ТЕСТ-1	$\pm 0,5$ $\pm 1,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения перемещения активного захвата при прямом ходе, %	$\pm 2,0$
Диапазон измерения перемещения активного захвата, мм	5~100

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматизированные испытательные прессы ИП-1000-А-ТЕСТ оснащены полностью автоматизированной системой управления «M-Test АСУ», которая позволяет не только регистрировать и обрабатывать результаты, но и управлять испытательной машиной с ПК как в ручном, так и в соответствии с заданным алгоритмом испытания в автоматическом режиме.

В том числе автоматизация позволяет:

- проводить испытания в автоматическом режиме с ПК;
- строить графики в режиме реального времени «Нагрузка – Перемещение», «Нагрузка – Время», «Перемещение – Время»;
- определять текущее и максимальное значение нагрузки и деформацию приложенной к образцу;
- определять текущие скорости перемещения (мм/с) и нагружения (кН/с);
- экспортировать результаты испытаний в формат Excel и др. форматы;
- сохранять результаты испытаний и загрузки ранее сохраненных результатов для последующей обработки;
- подключить дополнительные датчики и учет их показаний в расчетах.

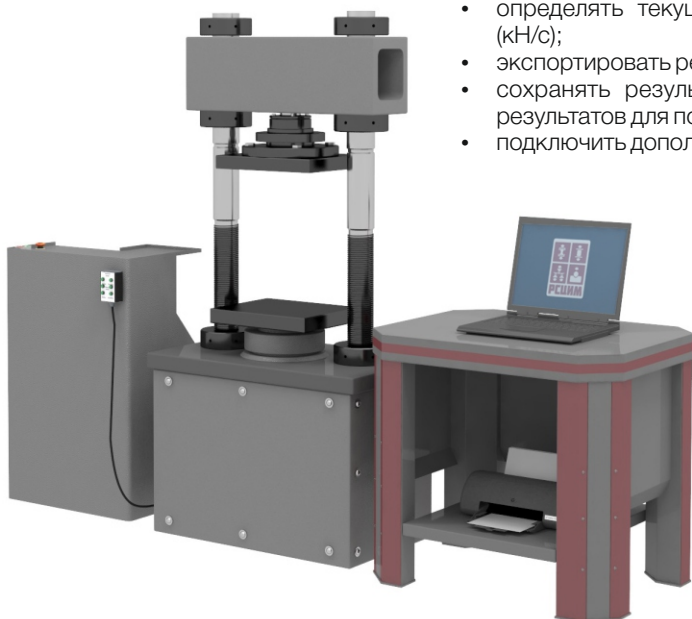

Технические характеристики автоматизированной машины П-1000-А-ТЕСТ:

Цена наименьшего разряда силоизмерителя в зависимости от максимального усилия машины, кН	0,001
Диапазон рабочих скоростей нагружения, кН/с	1~100
Пределы допускаемой относительной погрешности силоизмерителя, % · модификация ИП-1000-А-ТЕСТ-2 · модификация ИП-1000-А-ТЕСТ-1	± 0,5 ± 1,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения перемещения активного захвата при прямом ходе, %	± 2,0
Диапазон измерения перемещения активного захвата, мм	5~100